


1、30万元及以上仪器设备接入共享平台

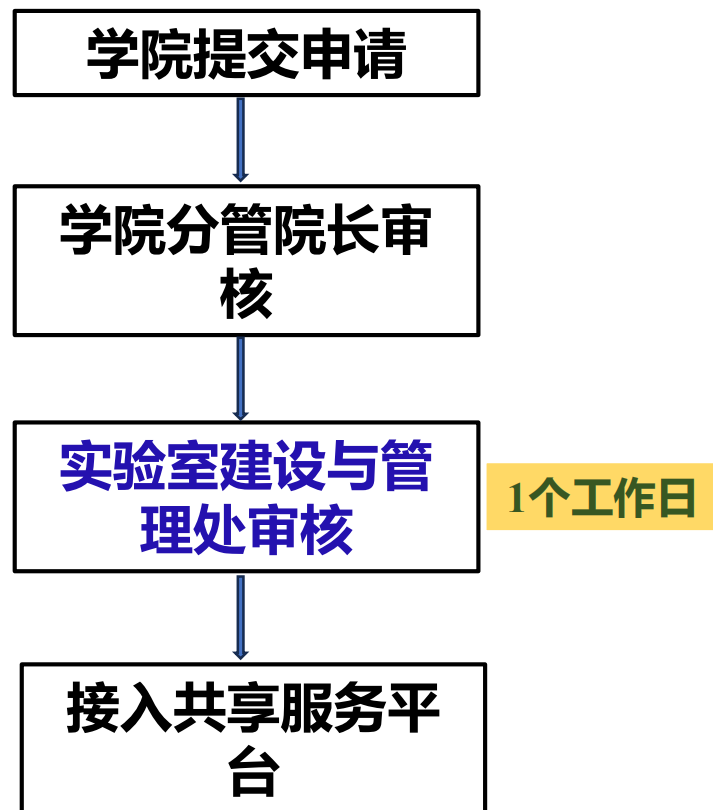

1. 所需材料: 包含设备详细信息、性能参数、技术指标、运行状态、预约模式等。

2. 注意事项: 如涉密以及有其他正当理由或特殊原因不适合开放共享的仪器设备, 经向实验室建设与管理处书面申请同意后可不实行开放共享。

3. 说明: 减少了院长审核环节, 时限比原来减少了2个工作日

图1、大型仪器设备共享申请接入流程图